

## RAMPA COM 2, 3, 4, 5 E 6 TORNEIRAS LIPIDO-RESISTENTE RP2000M/RP3000M/RP4000M/RP5000M/RP6000M

**GAMA:** Infusão

**APLICAÇÃO:** Infusão

**SEM LÁTEX**


**SEM FALATOS**

**DEHP (DOP), BBP, DBP, DIBP e DHP**

não fazem parte da composição do produto.

*Os níveis residuais destas substâncias estão de acordo com o regulamento REACH*

### DESCRIÇÃO

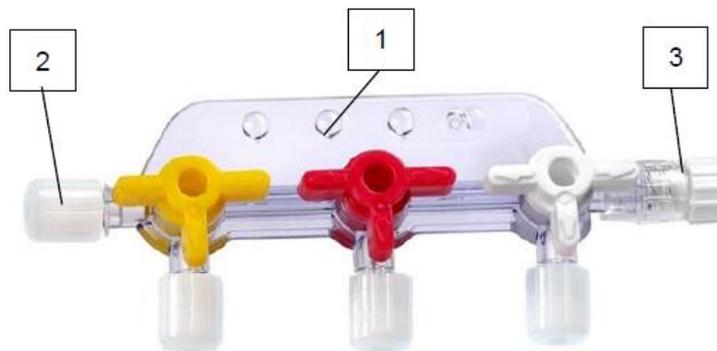

#### Legenda

1. Rampa com torneiras (corpo em Policarbonato, pega em HDPE, anel amovível em PC);
2. Tampas impermeáveis em HDPE;
3. Tampa protetora em PE.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Duração de utilização: 7 dias lípido-resistente

Pressão de utilização: 2 bar / 29 Psi (em conformidade com EN ISO 8536-4/8/9/10)

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VOLUME RESIDUAL APROX.
RP2000M	Rampa com 2 torneiras com 3 saídas fêmeas luer lock e 1 anel amovível macho	2.2ml
RP3000M	Rampa com 3 torneiras e 4 saídas fêmeas luer lock e 1 anel amovível macho	3.3ml
RP4000M	Rampa com 4 torneiras e 5 saídas fêmeas luer lock e 1 anel amovível macho	4.2ml
RP5000M	Rampa com 5 torneiras com 6 saídas fêmeas luer lock e 1 anel	5.8ml

	amovível macho	
RO6000M	Rampa com 6 torneiras com 7 saídas fêmeas luer lock e 1 anel amovível macho	6.8ml

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Consultar as instruções de utilização da referência 5C4998.

Estéril excepto em caso de embalagem danificada ou aberta; Não reesterilizar; Descartar após utilização.

Não utilizar pinças. Um estrangulamento excessivo pode danificar os luers e dificultar a desconexão.

Verificar periodicamente a conexão (no mínimo uma vez por dia).

No que diz respeito à rampa, deixe sempre os tubos não utilizados fechados. Antes de conectar ao paciente, verifique se todos os tubos estão totalmente vedados ou conectados a outro dispositivo.

Coloque sempre a rampa à mesma altura da orelha direita do paciente ou inferior. Nunca colocar a rampa acima desta altura.

## COMPATIBILIDADE DE MATERIAIS

Consultar as instruções de utilização da referência 5C4998.

Todos os componentes do dispositivo são compatíveis com emulsões lipídicas e uma vasta quantidade de desinfetantes clássicos, nomeadamente desinfetantes com uma base alcoólica.

## PRODUÇÃO

Injecção de componentes

Montagem manual e automática

## CONTROLO DE QUALIDADE

Controlo visual: ausência de riscos, manchas, quebras, deformações.

Controlo dimensional

Controlo funcional: (pressão, estanquicidade)

## ELIMINAÇÃO DE DISPOSITIVO

Os dispositivos utilizados deverão ser descartados juntamente com o lixo contaminado e incinerados.

## ESTERILIZAÇÃO

Modo de esterilização: óxido de etileno

Validação e controlo de rotina de acordo com as normas internacionais ISO 11135-1

A CAIR LGL não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

## VALIDADE

Data de validade: 59 meses

## ACONDICIONAMENTO

Armazenar em local limpo e seco, protegido da luz solar, a temperatura entre +5 e +40 °C

## EMBALAGEM

Embalagem individual: 1 face de papel e 1 face transparente

Caixa: 20 unidades por caixa de cartão

Caixa completa: 320 unidades por caixa de cartão

## INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico estéril de uso único

Classe IIa, com marcação CE

Organismo Notificado: G-MED, nº 0459

Código NPDM: *Rampas (A0702)*

Referência Fabricante	ID atribuído pelo INFARMED	Código CDM
RP2000M	105937	14264315
RP3000M	559	14264285
RP4000M	64561	17184924
RP5000M	10067	14264307

## ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone. REACH: Regulação europeia acerca do registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas. A comunicação de informação acerca das substâncias visadas é obrigatória se for superior a 0.1% massa/massa.